



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
KLASA: 406-05/19-01/145
URBROJ: 513-02-1420/17-19-9
Zagreb, 20. studenog 2019. godine

SVIM PREUZIMATELJIMA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA
EV. BROJA JAVNE NABAVE: 31-19-JN

PREDMET: Jednostavna nabava Kemikalija (reagensi, standardi), ev. br. 31-19-JN
- Izmjena br. 1. Poziva za dostavu ponuda, dostavlja se

Poštovani,

Dana 12. studenoga 2019. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava objavila je Poziv za dostavu ponuda za nabavu Kemikalije (reagensi, standardi), ev. br. nabave: 31-19-JN.

Naručitelj dostavlja odgovore na upite zaprimljene dana 18. studenoga 2019. godine, od gospodarskih subjekata, preuzimatelja Poziva za dostavu ponuda u predmetnom postupku.

Pitanje br. 1.: Dostavljamo Vam popis stavki koje uključuju etanole koji podliježu trošarini te je potrebno ispod svake stavke u troškovniku dodati "trošarina za etanol"

42	Etanol apsolutni za HPLC, Honeywell, 34870
----	--

ispod te stavke dodati:

Trošarina za etanol

44	Etanol, 96%
----	-------------

Trošarina za etanol

Odgovor br. 1.: Naručitelj ne prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta za izmjenom Troškovnika. Troškovnik obuhvaća zbirnu cijenu za etanol i trošarinu na etanol (stavke nisu izdvojene). Ponuditelj na računu prilikom naplate izdvaja cijenu same kemikalije - etanola i iznosa za trošarinu na etanol.

Pitanje br. 2.: Jeste li oslobođeni plaćanja trošarine na etanol i ako jeste po kojem broju Rješenja?

Odgovor br. 2.: Naručitelj nije oslobođen od plaćanja trošarine.

Pitanje br. 3.: U dokumentaciji za nadmetanje stoji pod točkom 4.1. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti da treba dostaviti certifikate o sastavu i sigurnosno-tehničke liste (STL). Molim Vas informaciju trebamo li dostaviti to sve uz ponudu ili je dovoljno uz isporuku jer je to jako velika

količina papira jer svaki STL ima otprilike 15-20 stranica? Certificate analize uz ponudu na žalost ne možemo dostaviti jer unaprijed ne znamo koja će nam šarža biti na redu za isporuku tijekom iduće godine.

Odgovor br. 3.: U točki 2.5. Rok i način isporuke robe Poziva za dostavu ponuda navedeno je:

„Prilikom isporuke kemikalija Službi za carinski laboratorij, obavezno je dostaviti sigurnosno tehnički list i certifikat analize sa navedenim datumom roka trajanja kemikalije. U slučaju da rok ističe u kratkom vremenu nakon narudžbe ista će se vratiti.“

Certifikati o sastavu i sigurnosno-tehnički listovi (STL) se ne dostavljaju u ponudi, te se točka 4.1. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti **bríše**, a točka 2.5. Rok i način isporuke robe **mijenja**:

„Prilikom isporuke kemikalija Službi za carinski laboratorij, obavezno je dostaviti sigurnosno tehnički list i certifikat analize **s navedenim datumom roka trajanja** kemikalije. U slučaju da rok ističe u kratkom vremenu nakon narudžbe ista će se vratiti.“

tako da ista glasi:

„Prilikom isporuke kemikalija Službi za carinski laboratorij, obavezno je dostaviti sigurnosno-tehnički list, koje sadrže osnovne informacije o proizvodima, podatke o rizicima, mjere u pogledu zaštite zdravlja, ljudi i sigurnosti na radnom mjestu te zaštite okoliša, i certifikat analize ili certifikat o sastavu **s navedenim datumom roka trajanja** kemikalije. U slučaju da rok ističe u kratkom vremenu nakon narudžbe ista će se vratiti. Za robu koja ima certificirani referentni standard (CRM) dostaviti Certificate o Certificiranim referentnim materijalima (CRM).“

Naručitelj **mijenja redne brojeve** točaka Poziva za dostavu ponuda 4.-14. tako da glase 4.-13.

Pitanje br. 4.: Molim Vas informaciju za stavku 36. Difenilamin, 99%, piše da trebete pakiranje 500mL no proizvođači imaju pakiranja u gramima tj. kilogramima, možemo li Vam ponuditi 500 grama pakiranje za tu stavku?

Odgovor br. 4.: Naručitelj prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta. Može se ponuditi pakiranje od 500 grama.

Naručitelj **mijenja** stavku pod rednim brojem 36. Troškovnika u stupcu Jedinično pakiranje 500ml u 500ml ili 500g.

Pitanje br. 5.: Stavka 95 Plovučac (plavac) kamen granulat, < 1,5 mm- možemo li Vam ponuditi veličinu čestica 0,8-3 mm?

Odgovor br. 5.: Naručitelj ne prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta. Naručitelj nabavlja Plovučac (plavac) kamen granulat, < 1,5 mm.

Pitanje br. 6. Stavka 133 Ugljikov disulfid, GC- treba li biti za GC ili treba biti analiziran GC-om? Možete li nam dati kataloški broj da ponudimo baš ono što trebete?

Odgovor br. 6.: Kataloški broj je Sigma Aldrich 180173, CAS RN 75-15-0 ASC reagent $\geq 99,9\%$, važno je da kemikalija treba biti čistoće za GC analizu, ne treba biti analiziran GC-om.

Naručitelj **mijenja** stavku pod rednim brojem 112. Troškovnika:
„Ugljikov disulfid, GC;“


tako da glasi:

„Ugljikov disulfid, GC; Kataloški broj je Sigma Aldrich 180173, CAS RN 75-15-0 ASC reagent >= 99,9 %“

Pitanje br. 7.: Stavka 75. Mineralno ulje (Low-ash mineral oil), bijelo ulje s manje od 0.005 % m/m sulfatnih pepela, CAS: 8042-47-5, GRAM-MOL P744623- artikl Gram Mol P744623 Bijelo mineralno ulje više ne postoji (potvrda proizvođača je u privitku) možemo li Vam ponuditi drugog proizvođača koji zadovoljava tražene uvjete da ima manje od 0.005 % m/m sulfatnih pepela?

Odgovor br. 7.: Naručitelj prihvaća zahtjev ovog gospodarskog subjekta. Može se ponuditi jednakovrijedan artikl drugog proizvođača koji zadovoljava tražene uvjete

Pitanje br. 8.: Stavka 47 F.A.M.E. MIX C8-C24, Supelco 18918 više ne postoji tj. ukinuta je (slika dolje) i dobavljač nam je rekao kako ne postoji adekvatna zamjena u ovome trenutku obzirom na to molim Vas da ju uklonite iz troškovnika?

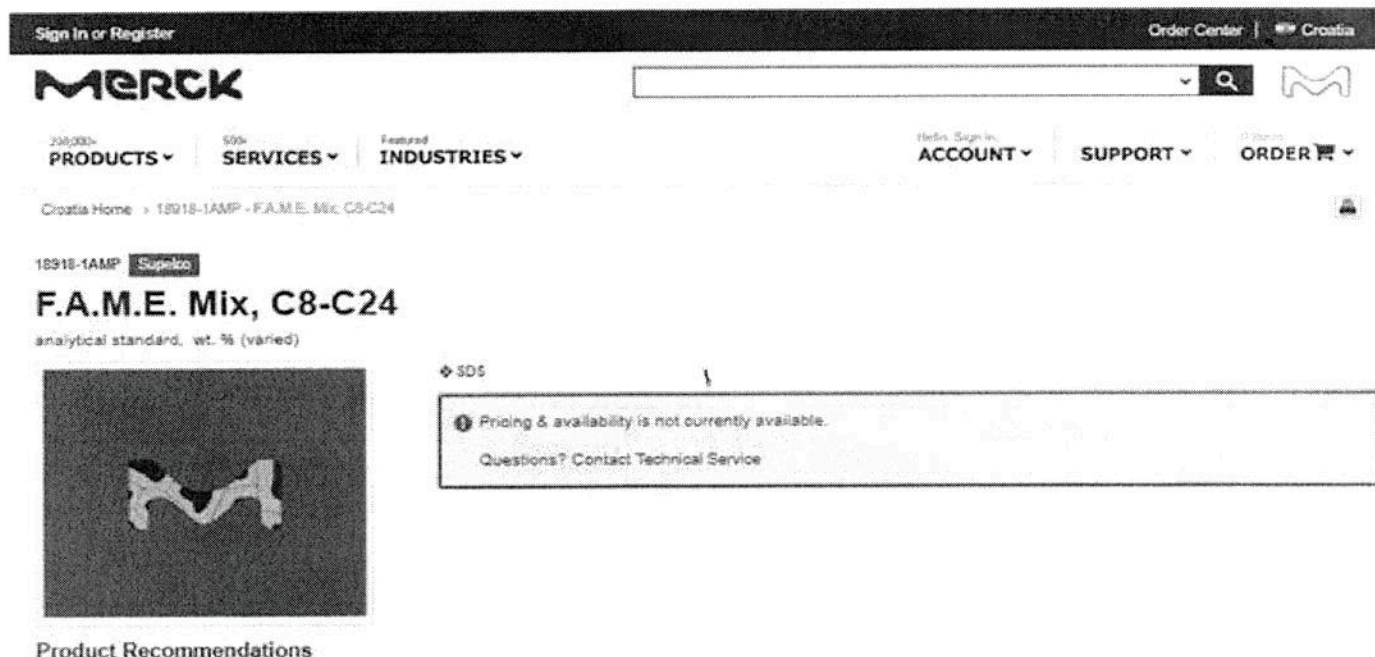

Sign In or Register Order Center | Croatia

MERCK

200,000+ PRODUCTS | 500+ SERVICES | Featured INDUSTRIES


Help | Sign In | ACCOUNT | SUPPORT | ORDER

Croatia Home > 18918-1AMP - F.A.M.E. Mix, C8-C24

18918-1AMP **Supelco**

F.A.M.E. Mix, C8-C24

analytical standard, wt. % (varied)

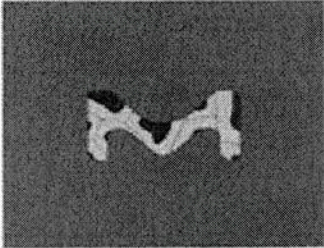

SDS

Pricing & availability is not currently available.

Questions? Contact Technical Service

Product Recommendations

Odgovor br. 8.: Naručitelj prihvaća prijedlog ovog gospodarskog subjekta te u Prilogu br. 2. Poziva za dostavu ponuda mijenja **Troškovnik**, tako da se **stavka** pod rednim brojem **47. F.A.M.E. MIX C8-C24, Supelco 18918 briše.**

Naručitelj **mijenja rok za dostavu ponuda** u točki 5.4. Poziva za dostavu ponuda (Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda), umjesto 21. studenoga 2019. godine u 13 sati novi rok za dostavu ponuda glasi **26. studenoga 2019. godine u 13 sati.**

Naručitelj ovu Izmjenu br. 1. Poziva za dostavu ponuda bez odgode stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja, te se ono nadalje smatra dijelom Poziva za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

POMOĆNICA RAVNATELJA

